Test PCR per clamidi genitali e gonorrea

Kit per l'auto-raccolta di un campione di urina per il test di clamidi genitali e gonorrea, responsabili di malattie sessualmente trasmissibili. Il campione viene analizzato in laboratorio tramite PCR per la ricerca del DNA dei due patogeni. Il test è raccomandato dopo ogni rapporto sessuale a rischio di infezione. Per ottenere un risultato significativo, il test dovrebbe essere effettuato non prima di 14 giorni dopo il rapporto sessuale.

Contenuto della confezione

Codici a barre

Salviette disinfettanti



Monovette e punta di aspirazione



Sealbag

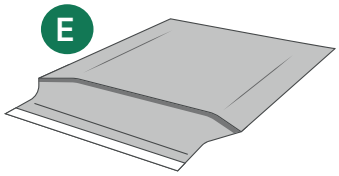

Scatola di ritorno

Effettuare il test non prima di 14 giorni dopo il rapporto sessuale a rischio di infezione.

Prelevare un campione

1. **L'ultimo passaggio in bagno dovrebbe essere più di un'ora fa.** Lavati le mani. Apri il pacchetto di salviette disinfettanti A e usale per disinfettare le mani.

2. Prendi un bicchiere pulito e urina un po' direttamente dentro (primo flusso di urina!). Svuota il resto della vescica nella toilette.

3. Apri l'imballaggio del Monovette B e della punta di aspirazione C. Rimuovi il tappo del Monovette e mettilo da parte per dopo. **Non gettarlo via!** Collega la punta di aspirazione al Monovette **(vedi immagine 1)**. Ora immergi la punta di aspirazione nel bicchiere di urina e riempi il Monovette fino al segno tirando fuori il pistone **(vedi immagine 2)**.

4. Prendi il Monovette contenente l'urina fuori dal contenitore e giralo a testa in giù in modo che la punta di aspirazione punti verso l'alto. Tira fuori il pistone il più possibile in modo che la punta si svuoti. Spezza il pistone **(vedi immagine 3)** e rimuovi la punta di aspirazione. Rimetti il tappo per chiudere il Monovette e smaltisci il pistone e la punta di aspirazione.

5. **Attacca il codice a barre incluso sul Monovette (vedi immagine 4)**. Metti il tubo di prova nella sealbag D. Chiudi la sealbag tirando via la striscia adesiva. Metti la sealbag nella scatola di ritorno E e chiudila **(vedi immagine 5)**. Metti la scatola di ritorno in una cassetta delle lettere prima dell'ultima raccolta del giorno. **In caso di calore estremo o freddo estremo, utilizza una cassetta delle lettere protetta o un ufficio postale per la spedizione al laboratorio.**

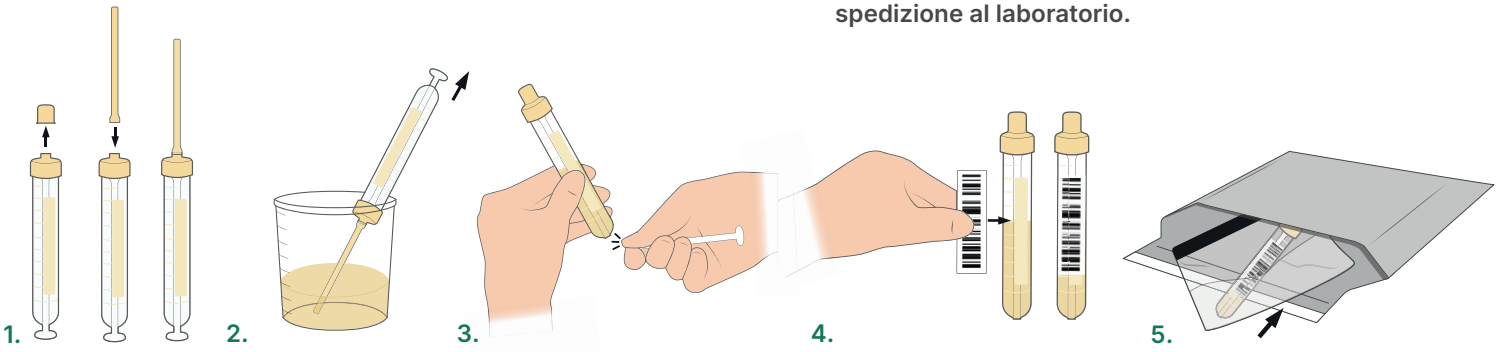

Risultati di laboratorio

I tuoi risultati saranno normalmente disponibili entro 1-2 giorni lavorativi dal momento in cui hai inviato il campione al laboratorio. Riceverai una notifica via e-mail quando i risultati saranno disponibili.

Questo prodotto è destinato all'uso singolo. Non utilizzare il test se l'imballaggio sterile del Monovette o il tubo stesso è danneggiato o se la data di scadenza (vedi confezione esterna) del test è passata. Richiedi un nuovo test contattandoci. Conservare e trasportare a temperature comprese tra 2 e 25 gradi. Eventuali incidenti gravi legati al dispositivo devono essere segnalati al produttore.

360-health.ch è un marchio di City Integration Switzerland GmbH, Rigiweg 21a, CH-6343 Holzhäusern. UID CHE-289.558.351.
E-mail: info@360-health.ch **Sito web:** www.360-health.ch